

Temperature Monitoring Log Investigational Product (治験薬保管温度記録)

checked and recorded daily(except weekends & public holidays) (営業日は毎日確認)


Refrigerator: 2-8°C Incubator: 15-25°C room temperature: 1-30°C deep freezer :under -80°C

Month(mm)/Year(yyyy):	Feb /20 20	
Date	Is temperature within limits?(Y/N) If not, write comments 温度は範囲内か?	Performed by Initials 確認者イニシャル
1	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
2	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
4	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	H.A
5	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
6	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
7	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
8	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
9	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
11	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
12	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
13	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
14	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
15	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
16	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
17	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
18	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
19	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
20	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
21	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
22	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
23	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
24	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
25	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
26	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
27	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
28	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
29	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
30	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
31	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	


温度計電池交換等記録【記載見本】		
該当する保管庫	冷蔵庫(②) ・ 恒温槽(①) ・超低温槽・室温	
開始日時	15:30	2017/6/10
終了日時	15:35	
実施者サイン	治験 太郎	
コメント		
☑はい ☐いいえ		

温度計電池交換記録		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
☐はい ☐いいえ		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
☐はい ☐いいえ		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
☐はい ☐いいえ		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
☐はい ☐いいえ		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
☐はい ☐いいえ		


comment	
---------	--




送信器名称 CH番号	室温 CH	治験恒温槽① CH	治験恒温槽② CH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃
収録データ数	2593	2593	2593
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	21.8	21.2	20.9
最低値	20.3	20.9	20.5
平均値	21.2	21.0	20.7

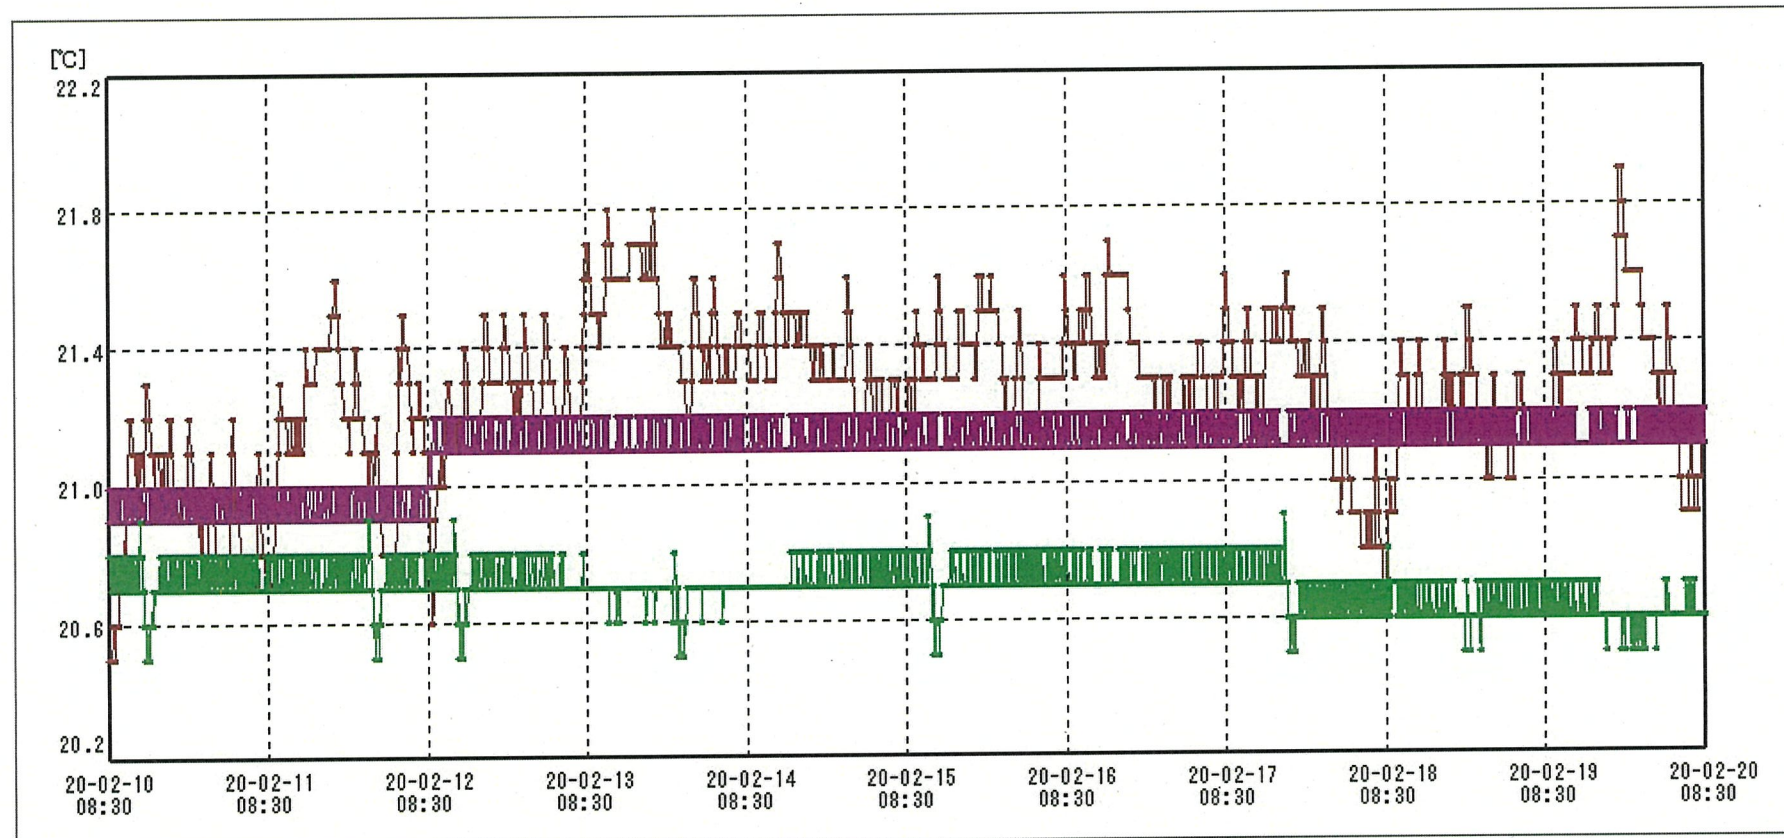


送信器名称 CH番号	室温 CHI	試験恒温槽① CHI	試験恒温槽② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃
収録データ数	2881	2881	2881
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	21.9	21.2	20.9
最低値	20.5	20.9	20.5
平均値	21.3	21.1	20.7




送信器名称 CH番号	室温 CHI	治験恒温槽① CHI	治験恒温槽② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃
収録データ数	2881	2881	2881
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	22.0	21.2	20.9
最低値	20.9	21.0	20.4
平均値	21.4	21.0	20.6



送信器名称 CH番号	サブ機 CHI	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫④ CHI	治験冷蔵庫⑤ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C	°C	°C	°C	°C	°C
収録データ数	2593	2593	2593	2593	2593	2593
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	4.9	5.5	5.7	4.9	5.0	4.1
最低値	4.6	5.0	5.4	4.7	4.2	3.6
平均値	4.8	5.3	5.5	4.8	4.5	3.9



送信器名称 CH番号	サブ機 CHI	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫④ CHI	治験冷蔵庫⑤ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2881	2881	2881	2881	2881	2881
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	4.8	5.2	5.7	5.1	5.0	4.1
最低値	4.6	4.9	5.5	4.7	3.5	3.8
平均値	4.7	5.0	5.6	4.8	4.4	4.0



送信器名称 CHI番号	サブ機 CHI	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫④ CHI	治験冷蔵庫⑤ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	2881	2881	2881	2881	2881	2881
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	4.8	5.2	5.7	5.2	4.9	4.2
最低値	4.5	4.9	5.4	4.4	3.9	3.7
平均値	4.6	5.0	5.6	4.8	4.3	3.9